Структурные ограничения
по весу пользователя

SmartIP

цилиндр управления фазой переноса

Инструкции для протезиста

239629

Blatchford

Крепление цилиндра управления для коленного модуля SMARTIP к шасси ESK+ с цельной голенью

(Сборочный комплект 019768)

Ограничитель разгибания коленного модуля (6 . должен быть полностью утоплен в корпус. Проведение юстировки не требуется.

⚠ ´ÓÐáÌÓÇÅ×ÊÐá ÔÕÐÈÈÌÁÐÈÔÇÕÓÑÒÍ×á
Ó ÔÓ×ÊÐáÙÐÎ ÓÔÅÖÒÓÐÈÔÎÐÈÎÇ

SMARTIPSFF
SMARTIP4BF

Резьбовой фиксатор /R F W L W
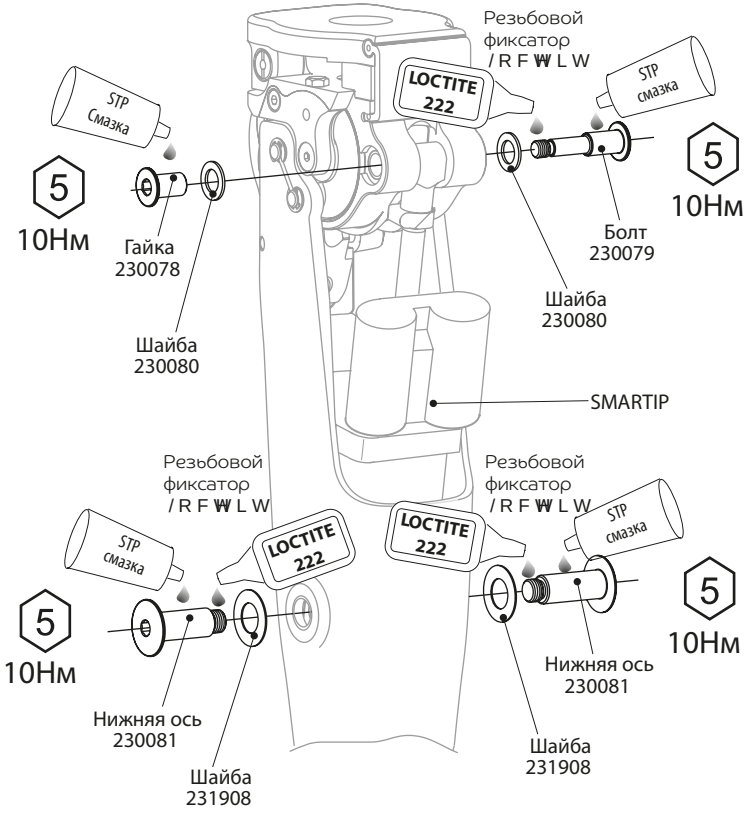
Отсоедините цапфу и перед установкой нанесите фиксатор / R W 243, H стяжной винт не затягивайте.